

発行日 26, Nov 2008
Date of Issue

宛：サンプル（標準ガスモデル：英文）
To

株式会社 山武
アドシスオートメーションカンパニー
品質保証 1 部

件名：計測器のトレーサビリティ証明

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
このたび、ご請求のありましたトレーサビリティ証明書として以下を発行いたします。

- ・製品検査成績書
- ・トレーサビリティ証明書
- ・トレーサビリティ体系図

*製品検査成績書は、製品と同梱しています。

当社は1991年10月にISO9001の認証を受けており、その後も定期的に審査を受け認証を継続しております。計測器管理におきましても、国家標準とのトレーサビリティを確保しております。

敬具

Subject : Traceability Certificate Issuance

Attached please find the following documents to certify the traceability of the product to the National Standards.

- ・ Inspection Report
- ・ Traceability Certificate
- ・ Traceability Chart

Inspection Report is bundled with the product.

The quality system of Yamatake Corporation, including the measuring instruments control system, was certified on October, 1991 as ISO9001 and since then the certification has been updated. The traceability of our measuring instruments to National Standards has been also fulfilled.

1st. Quality Assurance Department
Advanced Automation Company
Yamatake Corporation

azbil

環境保護のため再生紙を使用しています

サンプル (標準ガスモデル: 英文)

発行番号
Certificate No. C081126-0007発行日
Date of Issue 26, Nov 2008トレーサビリティ証明書
TRACEABILITY CERTIFICATE1st. Quality Assurance Department
Advanced Automation Company
Yamatake Corporation*Masumi Hishinoya*責任者 紀伊国屋 真澄
Approved by担当者 船床 千恵
Person in charge製品名称
Product Name Digital Mass Flow Controller製品形番
Model No. MQV0005BSRS00001Y0デトコード
Date Code 0844製造番号
Serial No. *****

本製品に使用した計測器は、弊社計量管理規程によって管理され、下記の通り国家標準供給機関とのトレーサビリティが取れていることを証明します。

We certify that the measuring instruments to calibrate the above product are controlled according to the Measuring Instrument Control Standard of this company, and that the measuring instruments are traceable to National Metrology Institutes as shown in the following table.

■ Measuring Instruments ■

Instrument Name	Model No.	Serial No.	Instrument No.
Digital Multimeter	34401A	US96061107	100-1112
Voltage & Current generator	7651	12AB16193K	110-1231

■ Working Standards ■

Instrument Name	Model No.	Serial No.	Instrument No.
Multi-Product Calibrator	5500A	6855008	110-0007
Cal. System for Voltage, Current and Resistance	5720A (R6581) (3458A)	6590203 (5720A)	190-0001
Mass Flow Controller	MQV0005BSRS1S1Y0	00254	900-0088

■ Reference Standards ■


Instrument Name	Model No.	Serial No.	Instrument No.
DC Voltage Standards	732A	4625005	110-0001
Standard resistor	4210	1720129	150-0001
Standard resistor	SR104	934013	150-0002
Sonic Nozzle Flow Meter	MRS101~104/MRD100	MS14A015/MD11A028	900-0110

■ National Metrology Institute ■

HIRAI CORPORATION (JCSS)

Agilent Technologies (JCSS)

トレーサビリティ体系図 Traceability Chart

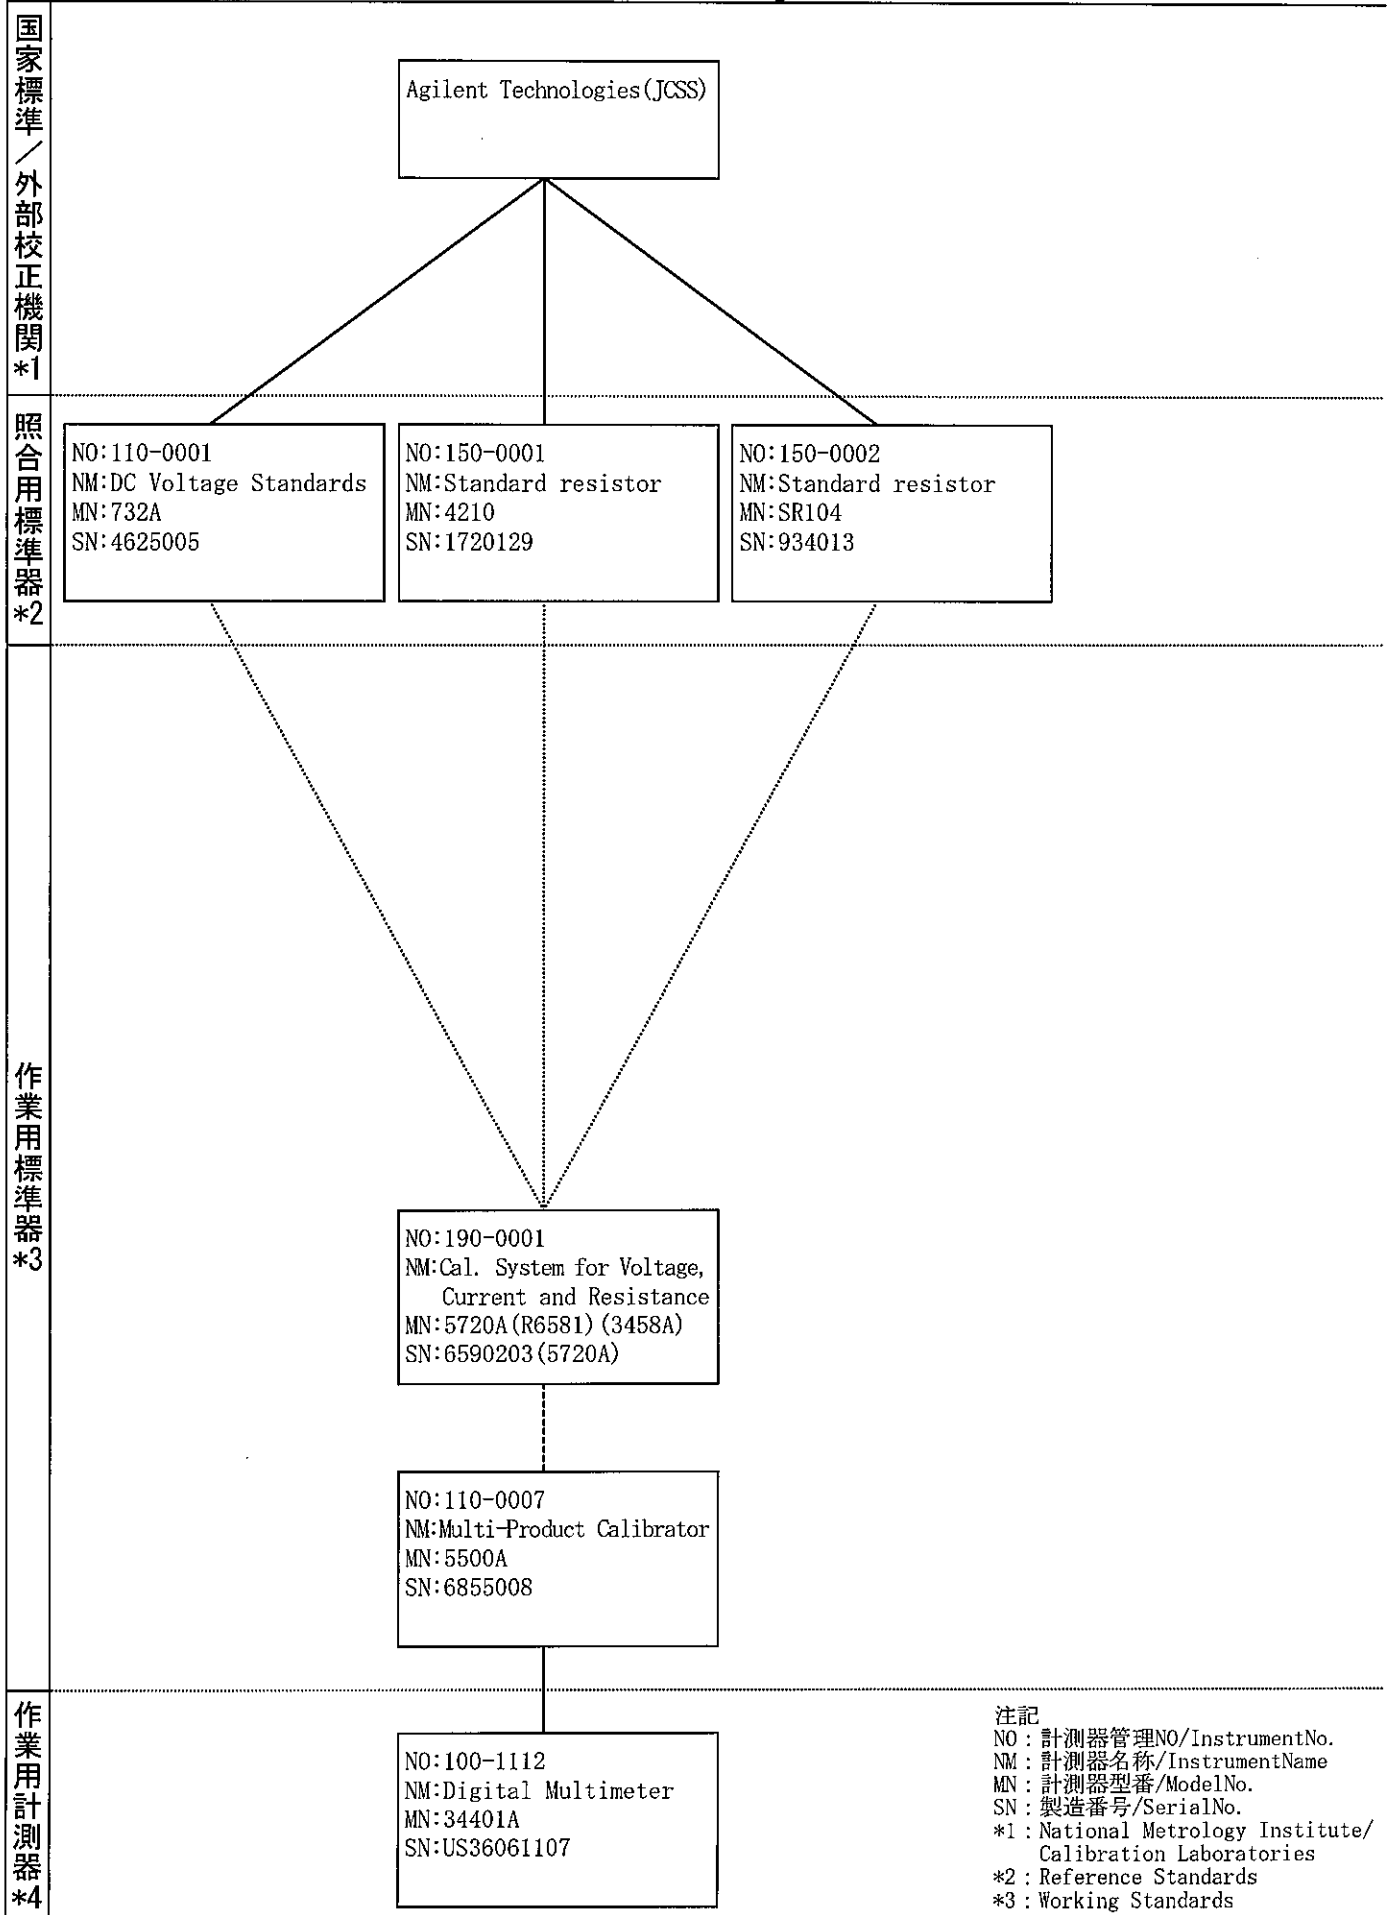

国家標準／外部校正機関*1


照合用標準器*2

作業用標準器*3

作業用計測器*4

注記
 NO : 計測器管理NO/InstrumentNo.
 NM : 計測器名称/InstrumentName
 MN : 計測器型番/ModelNo.
 SN : 製造番号/SerialNo.
 *1 : National Metrology Institute/
 Calibration Laboratories
 *2 : Reference Standards
 *3 : Working Standards
 *4 : Measuring Instrument

トレーサビリティ体系図 Traceability Chart

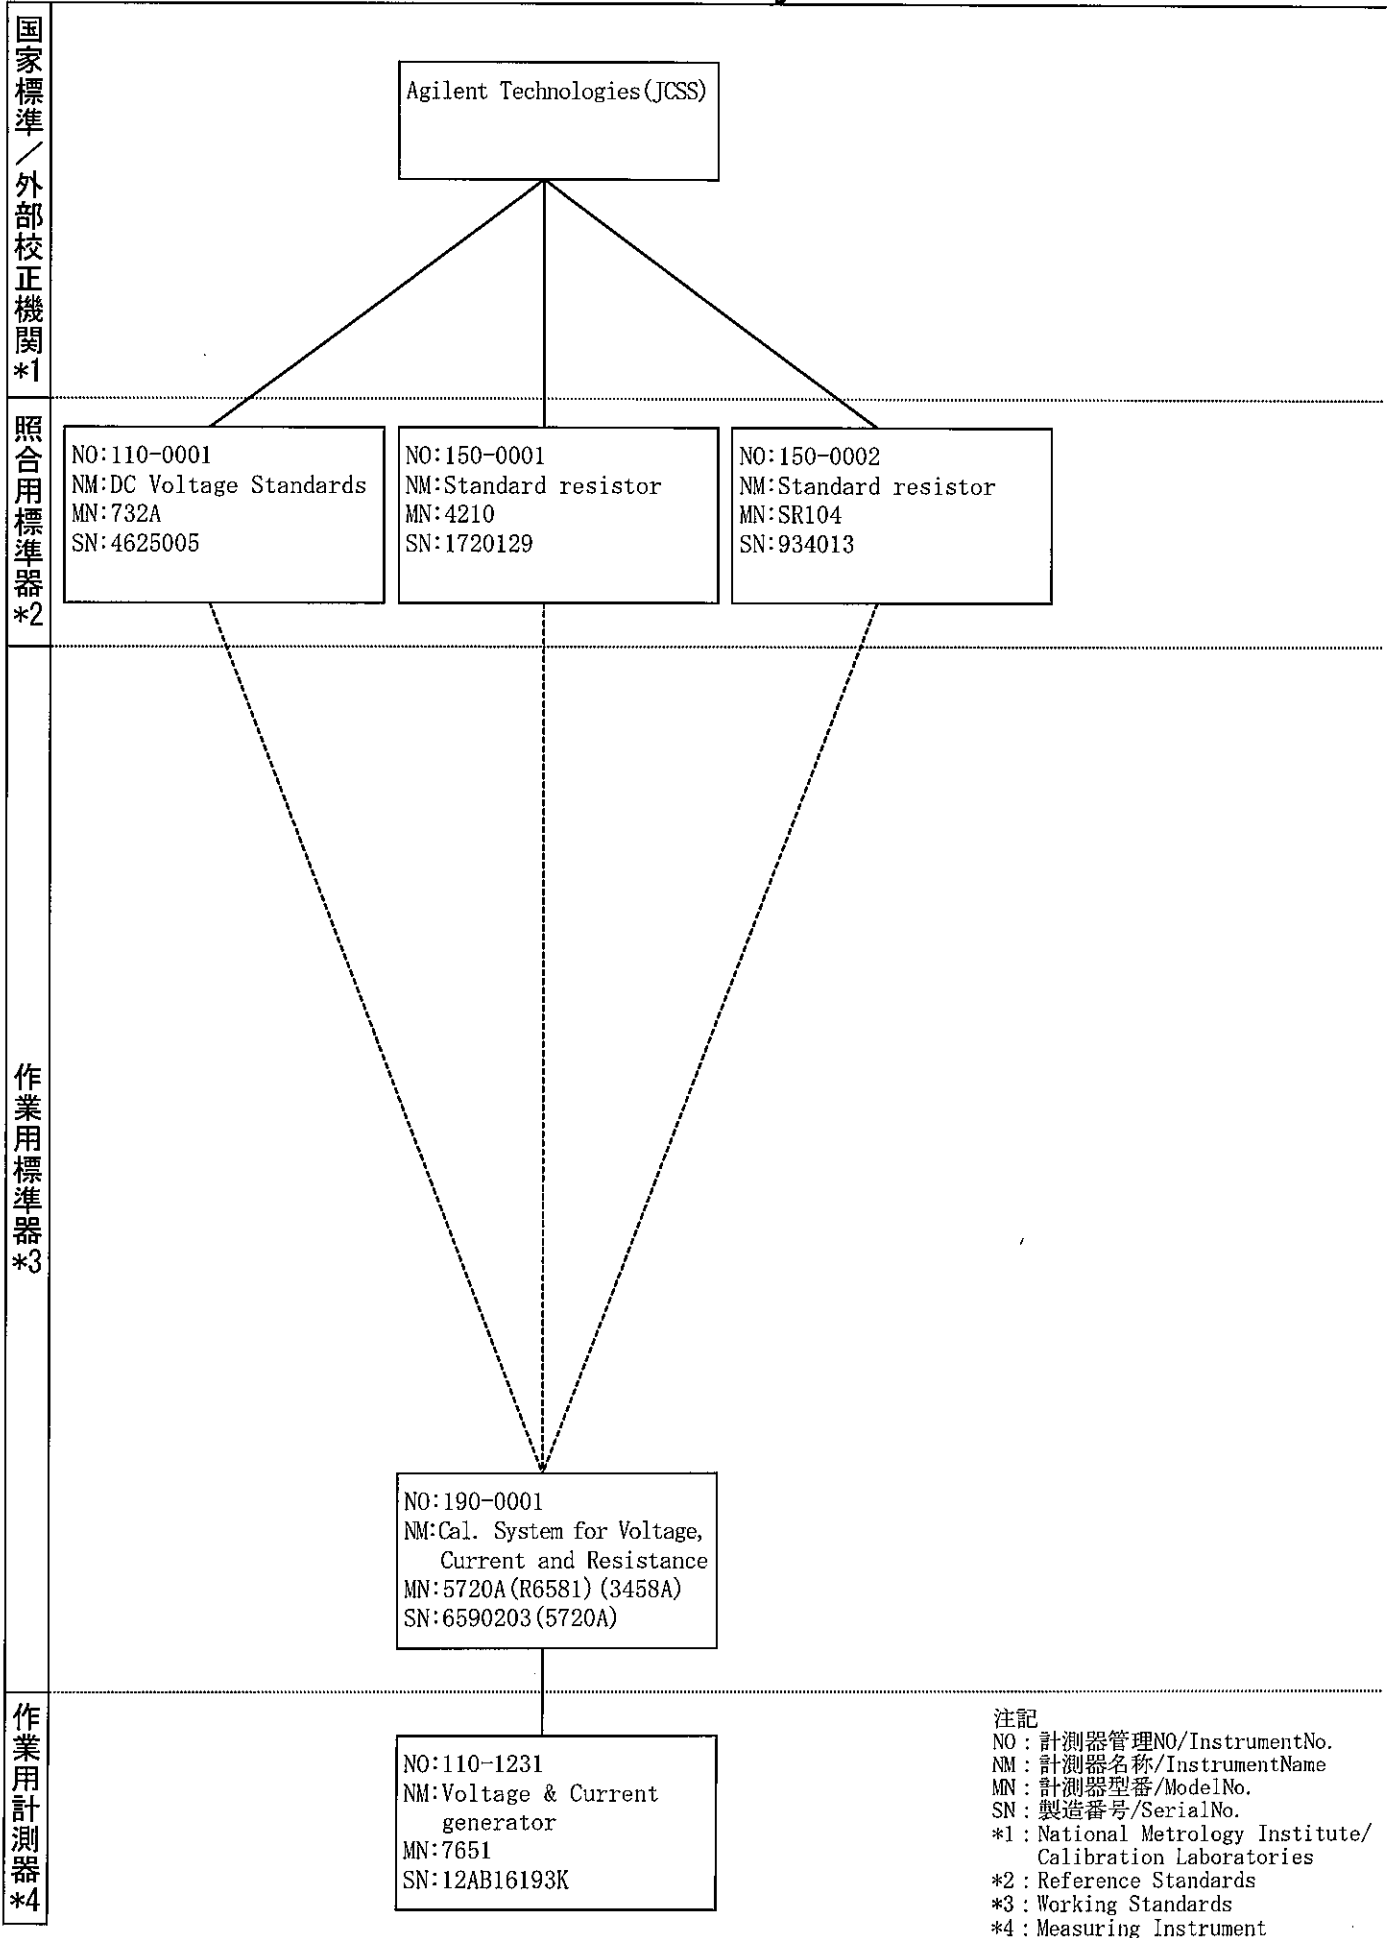

国家標準 / 外部校正機関 *1

照合用標準器 *2

作業用標準器 *3

作業用計測器 *4

注記
 NO : 計測器管理NO/InstrumentNo.
 NM : 計測器名称/InstrumentName
 MN : 計測器型番/ModelNo.
 SN : 製造番号/SerialNo.
 *1 : National Metrology Institute/
 Calibration Laboratories
 *2 : Reference Standards
 *3 : Working Standards
 *4 : Measuring Instrument

トレーサビリティ体系図 Traceability Chart

